

Bestillingsskjema RIC Propper Hansaton

Excite/Stratos

Receiver: S M P

Rec. lengde: 0 1 2 3

Ventilasjon: _____

SHD

Receiver: S P

Rec. lengde: 0 1 2 3

Ventilasjon: _____

Høyre

Venstre

Uten Allergibeh.

SlimTip Hard

Kanal

Kanal m/Vinge (canallock)

Silhuett (skeleton)

Kanal lengde:

N L

(normal-lang)

Titan (Av valgt propp)

SlimTip Myk

Kanal

Kanal m/Vinge (canallock)

NB! SlimTip myk kan ikke lages til SHD

cShell Hard

Kanal

Kanal m/Vinge (canallock)

Silhuett (skeleton)

Kanal lengde:

K N L

(Kort-normal-lang)

SP SP receiver (kun cShell Hard)


UP UP receiver (kun cShell Hard)

Sendes Høresentral

Sendes Pasient

Dato: _____

Ny time: _____

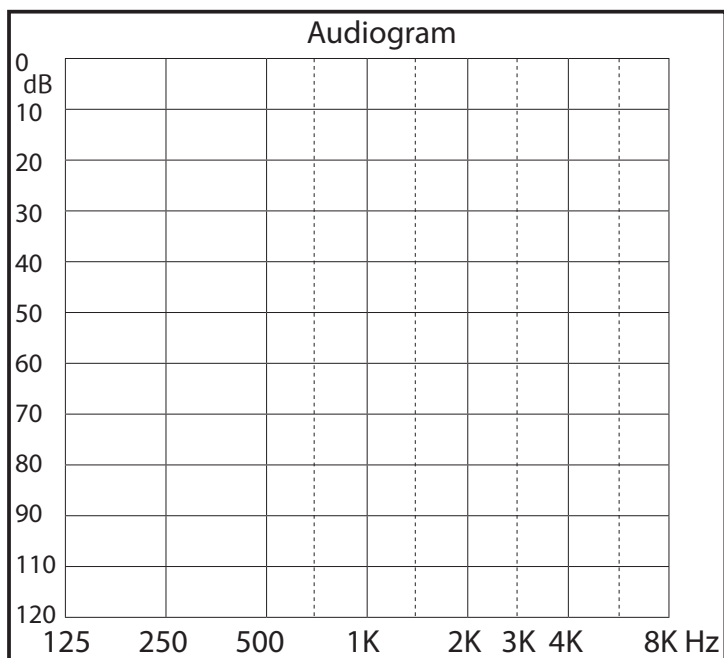

Rekv. Høresentral/Lege:

Pasientens navn:

Født:

Adresse:

Merknad:

Stempel og signatur